Kuraray Medical Dental-materials NEWS

クラレメディカル株式会社　歯科材料事業部

「クリアフィル® ファイバーポスト」新発売

2010年2月に発売いたしました「クリアフィル®ファイバーポスト」ですが、おかげさまでたくさんのご質問をいただいております。
今回は「クリアフィル®ファイバーポスト」や関連製品に関するご質問をご紹介します。

管理医療機器　歯科根管用ポスト成形品
クリアフィル® ファイバーポスト
医療機器認証番号：221ABBZX00166000

Q1 「クリアフィル® ファイバーポスト」の特長を教えてください。

A クラレメディカル独自の形状で強度、適合性、接着性に優れています。

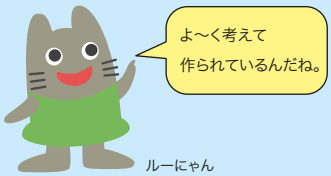

症例写真提供：
日野歯科医院　日野年澄先生
株式会社カスプデンタルサプライ/
カナレテクニカルセンター　山田和伸先生

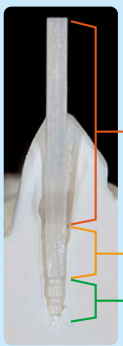

- 胴体部分はポスト自身の強度を考慮したストレートな形状
- 根尖への移行部は歯根の形状を考慮したテーパー型
- 根尖部へはレジンコアとの接着性（機械的嵌合）を考慮し溝を付与

Q2 「クリアフィル® ファイバーポスト」のサイズを教えてください。

A 下記のとおりです。



■寸法表　　単位：mm

品 名	L1	L2	R1（φ）	R2（φ）
No.2※	18	5	0.84	0.6
No.3	18	5	1.04	0.6
No.4	18	5	1.24	0.6
No.5	18	5	1.44	0.7
No.6	18	6	1.64	0.8

Q3 「クリアフィル® ファイバーポスト」の長さの調節はどのように行うのですか？

A 長さ調節にはダイヤモンドディスクを使用してください。（右図参照）
はさみや円盤状のカーボランダム、ファイバーカッターを使用するとポストを押しつぶしてしまい断面の荒れやファイバーがほぐれてしまう恐れがあります。また調節は必ず植立前におこなってください。

Q4 「クリアフィル® ファイバーポスト」に使用期限はあるのですか？

A 製品の梱包材に使用期限を記載しておりますので、使用前に必ずご確認ください。

※製品の使用期限についての詳しい資料はカスタマーサービス通信第1号をご覧ください。

Q5 「クリアフィル®ファイバーポスト」スターターセットにポスト孔形成用ドリルは含まれていますか？

A ドリルは含まれておりません。ポスト孔の形成にはポストと同じNO.のピーソリーマーをご使用ください。

Q6 「クリアフィル®ファイバーポスト」表面にサンドブラストは必要ですか？

A ポスト表面が損傷され、強度が低下してしまいますので、絶対に行わないでください。

Q7 「クリアフィル®ファイバーポスト」はX線造影性はありますか？

A ございません。

Q8 「クリアフィル®ファイバーポスト」にセラミックス処理（シランカップリング処理／シラン処理）は必要ですか？

A 「クリアフィル®ファイバーポスト」と支台築造用レジンの化学的結合が高まるので必ず行ってください。
グラスファイバーポストへの表面処理が不要な歯科接着用レジンセメント（例えば「クリアフィル® SA ルーティング」等）の場合は必要ありません。

Q9 「クリアフィル®ファイバーポスト」のセラミックス処理の手順を教えてください。

A 下記の手順で行ってください。

セラミックス処理材（シランカップリング処理材）の使用手順

※「クリアフィル®ファイバーポスト」の添付文書に記載の使用方法「本品の表面処理」を示します。

1 リン酸エッチング

管理医療機器 歯科用エッチング材
K エッチャント GEL
医療機器認証番号16100BZZ01130000号

2 セラミックス処理材の塗布

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
クリアフィル® セラミック プライマー
医療機器認証番号218ABBZX00041000号

セラミックス処理（シランカップリング処理）についての詳しい資料はカスタマーサービス通信第2号をご覧ください。

ルーにゃん

● 「クリアフィル」は株式会社クラレの商標登録です。
● ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。

ももリータ

製品・各種技術に関するお問い合わせ
URL www.kuraray-dental.com/

▸お問い合わせ専用フリーダイヤル
0120-330922
月曜～金曜 10：00～17：00

▸技工専用 フリーダイヤル
0120-730922
月曜～金曜 13：00～15：00

製造販売元 クラレメディカル株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3（大手センタービル）

連 絡 先 クラレメディカル株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3（大手センタービル）
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-39（新阪急ビル）
フリーダイヤル：0120-330992

販 売 元 株式会社モリタ
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834-6161
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
TEL.（06）6380-2525
http://www.dental-plaza.com

03/2010